

Wika Polska sp. z o.o. sp. k.

Inspection certificate according to EN 10204 – 3.1

Certificat d'étalonnage selon EN 10204 – 3.1

Page
Page 1 / 2

Customer:
Client: SOLYTEC
PARC CARNOT – REPUBLIQUE 7 ALLEE DES
ERABLES
VENISSIEUX
69200
FR

Certificate No.
Certificat N° WC018493Date
Date 26.02.2021Customer Order No.
N° commande client 19563Customer Part. No.
N° d'article du client 48789539Order Date
Date de commande 16.04.2021Order No. / Item
N° de commande CC420939/2
32992549Part No.
N° d'article 48789539Model
Type 213.53.100Serial number
Numéro de série 5403PCIQScale range
étendue d'échelle 0 ... 10 bar rel.Class
Classe 1,00 %Tag No.
Etiquette n°Reference
Référence
CPG2500 0,01% IS-50 -1 ... 32,1 bar rel.Calibration No.
N° de calibrage
SW-201-1-20 WPL 20-10Article text
Texte de l'article Bourdon tube pressure gauges, liquid filling,

HYTORC-Hustach
ZA Chemin de Montépy
69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
Tél. : 04 78 33 39 19
E-mail : sn@hytorc-ce.com
N° SIRET : 808 881 189 00019
TVA : FR 11 808 881 189

mise en service le 14/08/2025
G. Goux


Customer: SOLYTEC
Client: PARC CARNOT – REPUBLIQUE 7 ALLEE DES
ERABLES
VENISSIEUX
69200
FR

Certificate No. WC018493
Certificat N°
Date 26.02.2021
Date

Result
Résultat

Temperature 20°C +/- 5 K
Température

Test Item Candidat bar	Standard Référence bar	Meanvalue Moyenne bar	rel. Deviation rel. Ecart bar	Deviation Ecart %	Hysteresis Hystérésis %
0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2,000	1,988	1,970	1,979	0,021	-0,19
4,000	3,999	3,951	3,975	0,025	-0,48
6,000	5,999	5,991	5,995	0,005	-0,08
10,000	9,973	9,973	9,973	0,027	0,00

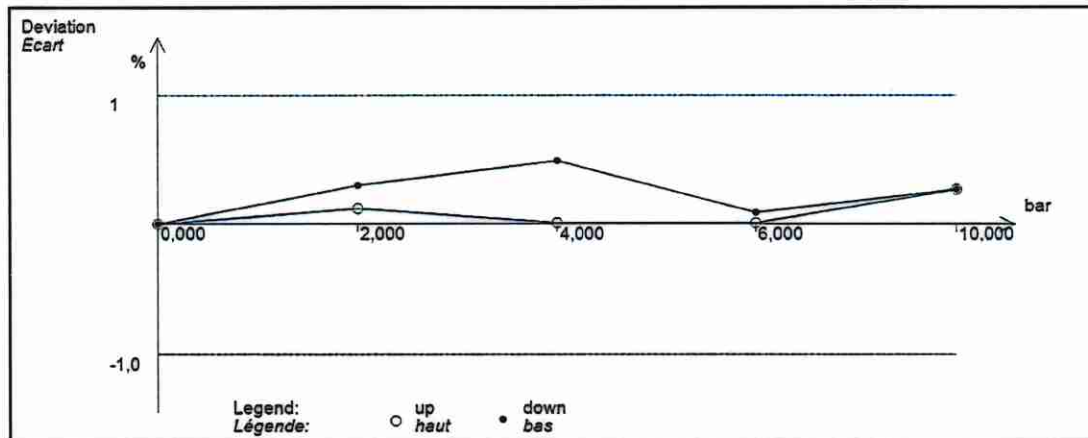

Object keeps the specification.
L'objet conserve ses caractéristiques.

Calibration was carried out according to the following norm:
L'étalonnage a été réalisé selon la norme suivante:

DIN EN 837-1

Remarks / Extension:

Inspection Representative (GA)
Spécialiste Ralf Gross

Examiner
Examineur S. Piekarski

This document was created automatically and needs no signature.
Etabli automatiquement, pas de signature requise