

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Certificat de reception selon EN 10204 - 3.1



Customer:
Client: SOLYTEC
PARC CARNOT - REPUBLIQUE 7 ALLEE DES
ERABLES
FR 69200 VENISSIEUX

Page
Page 1 / 2

Certificate No.
Certificat N° 01307133

Date
Date 25.04.2024

Customer order number
N° commande client 22097 Customer Part. No.
N° d'article du client 48854600 order date
Date de commande 17.04.2024


Order No. / Item
N° de commande S000465384/4 Part No.
N° d'article 48854600
Model
Type 213.53.100 Scale range
étendue d'échelle 0 ... 10 bar rel.
Serial number
Numéro de série 8975DWWB Class
Classe 1,00 %

Tag No.
Etiquette n°

Reference
Référence CPG2500 0,01% IS-50 -1 ... 32,1 bar rel. Calibration No.
N° de calibrage SW-48-23 WPL 24-10

Result
Résultat Temperature
Température 20°C +/- 5 K

Test Item Candidat bar	Standard Référence bar	Meanvalue Moyenne bar	rel. Deviation rel. Ecart bar	Deviation Ecart %	Hysteresis Hystérésis %
0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2,000	2,035	1,989	2,012	-0,012	-0,46
4,000	4,053	4,010	4,031	-0,031	-0,44
6,000	6,050	6,016	6,033	-0,033	-0,33
10,000	10,054	10,054	10,054	-0,054	0,00

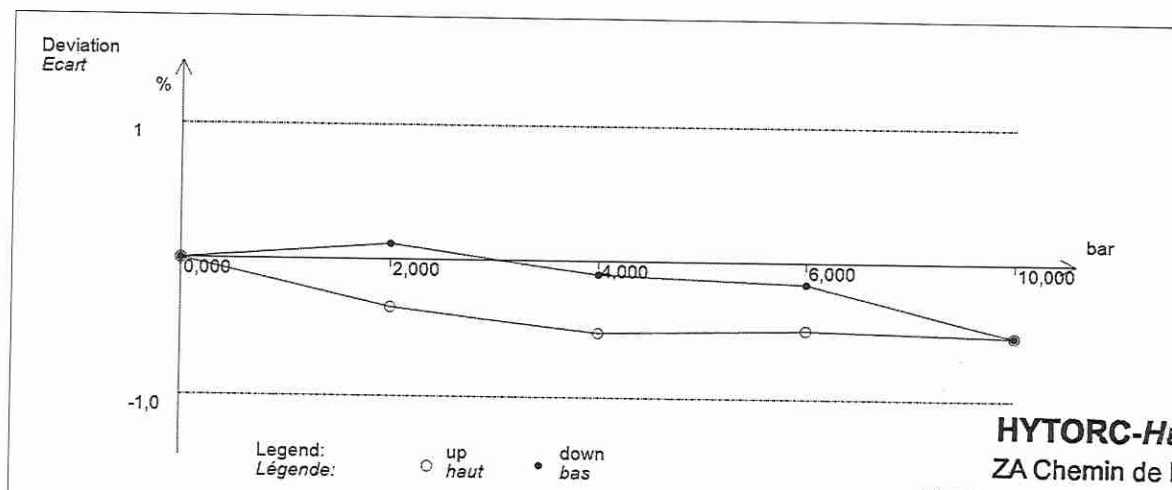

HYTORC-Hustach
ZA Chemin de Montépy
69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
Tél. : 04 78 33 39 19
E-mail : sn@hytorc-ce.com
N° SIRET : 808 881 189 00019
TVA : FR 11 808 881 189

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Certificat de reception selon EN 10204 - 3.1

Page 2 / 2
Page

Customer: SOLYTEC
Client: PARC CARNOT - REPUBLIQUE 7 ALLEE DES
ERABLES
FR 69200 VENISSIEUX

Certificate No. 01307133
Certificat N°

Date 25.04.2024
Date

Object keeps the specification.
L'objet conserve ses caractéristiques.

Calibration was carried out according to the following norm:
L'étalonnage a été réalisé selon la norme suivante:

DIN EN 837-1

Remarks / Extension:

Inspection Representative (GA)
Spécialiste Paweł Golasinski

Examiner S.Piekarski
Examineur

This document was created automatically and needs no signature.
Etabli automatiquement, pas de signature requise

HYTORC-Hurstach
ZA Chemin de Montépy
69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
Tél. : 04 78 33 39 19
E-mail : sh@hytorc-ce.com
N° SIRET : 808 881 189 00019
TVA : FR 11 808 881 189

*prise en service
le 14.11.2024
Gyil Goux
[Signature]*